


RS\_Base 拡張オプション  
キャプチャーシステム

# RS\_Capture

ビデオ・デジタル信号から画像をキャプチャーしRS\_Baseにファイリングできます

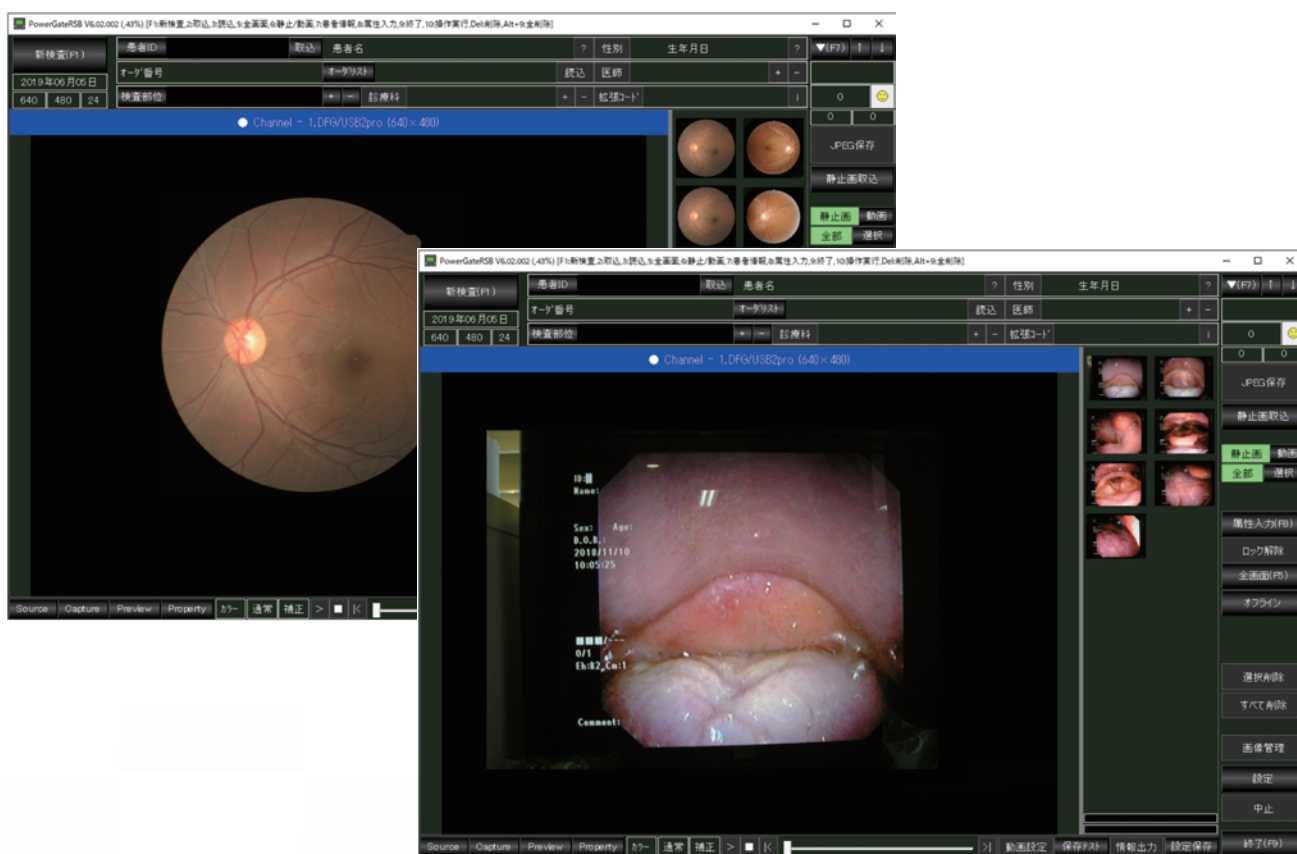

アナログ装置の  
ビデオ信号を  
画像変換




動画の取込速度  
および  
上限フレーム数の  
設定も可能



マウス操作、  
ハンドスイッチ・  
フットスイッチにも  
対応可能



キャプチャー後、  
必要ファイルのみ  
選択ファイリング  
可能



DICOM  
変換出力可能  
(オプション)

株式会社Medical-In

〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町2-19 ルーテル平和大通りビル1F  
TEL:082-962-5022 FAX:082-962-5033

Medical In

<http://www.rsbase.net/medical-in/>